


# Guide til montering af fodendskærm

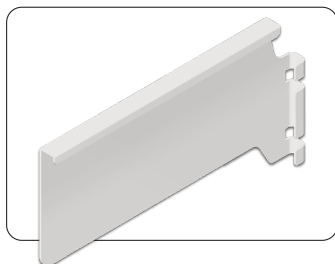

## BEMÆRK!

- ⚠ Vi gør opmærksom på, at fodendskærmen **IKKE** skal ses som et værn mod udstigning, men som en beskyttelse, til de patienter, der af den ene eller anden grund, er kropslige urolige.
- ⚠ Man må **IKKE** køre med bendelen, når fodendskærmen er monteret.

### STEP 1




Læg sengehestene ned i sammenklappet stilling.

### STEP 2




Hægt fodendskærmens kroge omkring fodendens sengegavl, således at den peger bagud på sengen.

### STEP 3

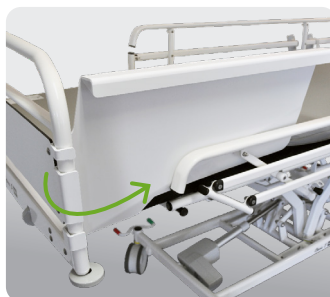


Drej nu fodendskærmen rundt, så den flugter med madrassen og skiltet "Denne side ud" vender udad.

### STEP 4

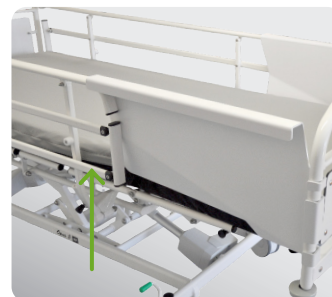

Løft sengehestene op. Fodendskærmen er nu monteret korrekt.


# Guide til montering af fodendskærm

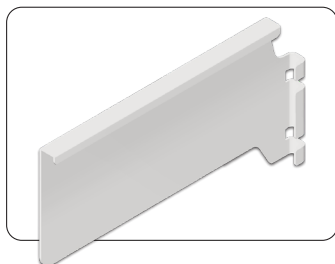

## MAX BELASTNING!


Max belastning afhænger af fodendskærmens position.

### A. FRITHÆNGENDE

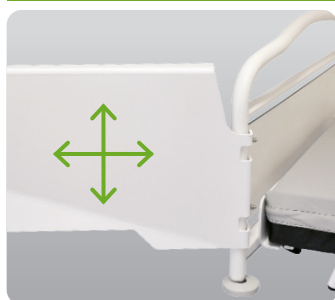

- ▲▼ : Max 2 kg
- ◀▶ : Max 2 kg

### B. MONTERET

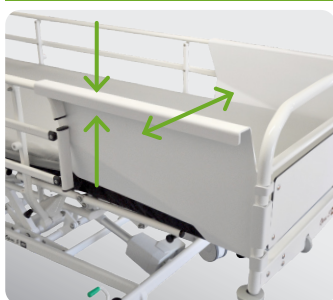

- ▲ : Max 2 kg
- ▼ : Max 40 kg
- ◀▶ : Max 30 kg